

韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目

询价通知书

项目编号：SGYC2017025XJ

采购人：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心

采购代理机构：韶关市优采招标代理有限公司

二〇一七年十一月


温馨提示

- 一、响应文件提交时间为**询价截止时间**前 30 分钟内。
- 二、为确保顺利报价，供应商必须根据询价通知书的要求进行报价。
- 三、报价保证金均以银行到账时间为判断依据，供应商应当充分考虑跨行、异地、网络系统延迟等因素，请适当提前交纳。为了避免出现意外情况，建议供应商在报价保证金交纳截止时间的 2 个工作日之前交纳报价保证金。
- 四、供应商请注意区分服务费收款帐号与报价保证金帐号的区别，切勿转错账户，以免导致无效报价或影响报价保证金退还的速度。
- 五、供应商报名参与分包项目的多个分包时，应当对应所报名的分包分别交纳报价保证金。报价时应当仔细检查分包号，分包号与分包名称必须对应。
- 六、供应商报名参与重新采购的项目时，应当按报名流程和交纳报价保证金流程重新操作交纳询价通知书工本费；重新交纳报价保证金）。
- 七、请仔细检查响应文件是否已按顺序编制页码，是否按询价通知书要求盖章、签名、签署日期。
- 八、以联合体形式参加询价的，请提交《联合体共同报价协议书》。
- 九、供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。
- 十、供应商为其为监狱企业，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
- 十一、供应商为残疾人福利性单位的，请提交《残疾人福利性单位声明函》
- 十二、成交供应商应当根据代理服务费交纳通知书向采购代理机构交纳代理服务费，再凭代理服务费的付款证明到采购代理机构开具发票，最后凭代理服务费的发票领取成交通知书。
- 十三、为使项目成交结果顺利公告，请已购买询价通知书的供应商及时到广东省政府采购网（网址：<http://www.gdgpo.com>）注册供应商账号。省财政厅审核通过后，提交韶关市区域申请，（用注册的用户名和密码登陆平台，在操作导航里的【供应商采购区域申请】，点击【增加】选择韶关市保存）由韶关市财政局审核（联系电话：8176550）。已注册过账号的供应商不需要重复注册（详见《供应商注册登记指南和流程》）。

供应商注册登记指南和流程

办事内容	供应商注册	类型	网上办事
申办条件 办理材料	(1) 具有独立承担民事责任的能力；(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(6) 法律、行政法规规定的其他条件。 需准备原件的彩色扫描件：营业执照或法人登记证、税务登记证、社保登记证、开户银行许可证、法定代表人身份证、机构管理员身份证、组织机构代码证		
受理部门、地点	广东省财政厅政府采购监管处 广州市越秀区仓边路 26 号 8 楼		
适用范围	在广东省范围内参与或从事政府采购活动的供应商		
办事依据	《中华人民共和国政府采购法》		
办理时间	周一至周五工作时间	咨询电话	020-83188500
承诺期限	2 个工作日	监督电话	020-83188515 83184060

省级供应商注册流程

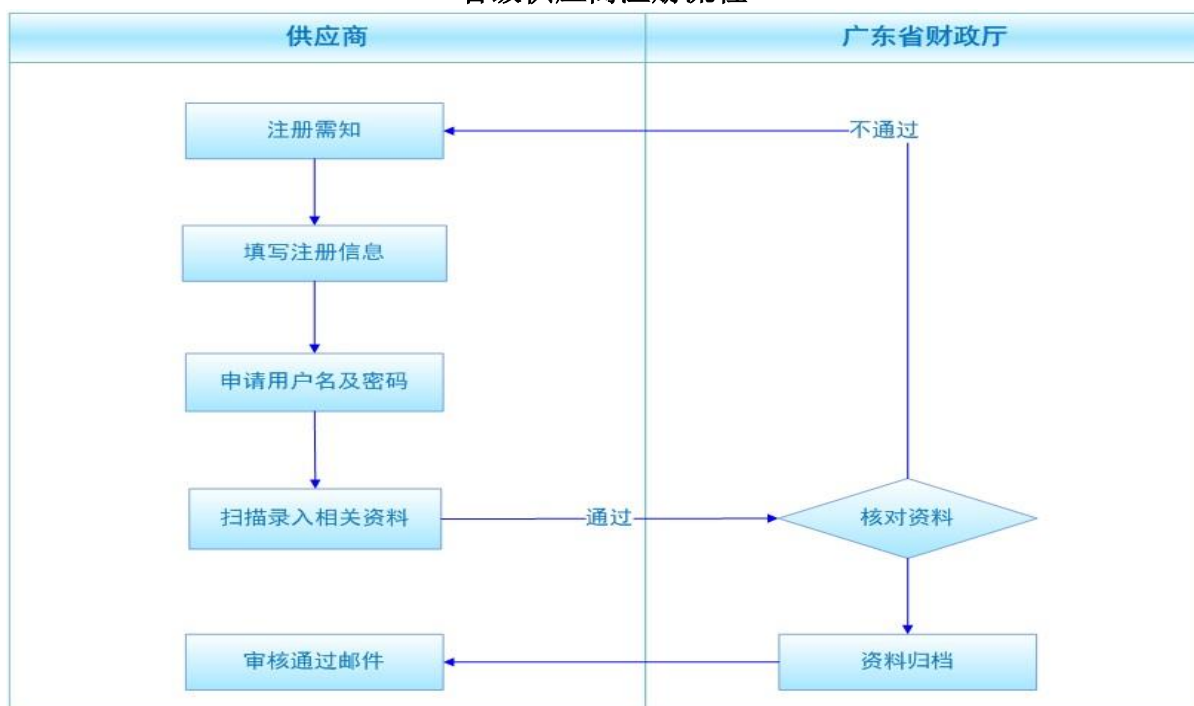

(以上温馨提示内容非询价通知书组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以询价通知书为准)

目 录

第一部分 询价邀请函	5
第二部分 用户需求书	8
一、采购项目技术规格、参数及要求	8
二、采购项目商务要求	29
第三部分 报价须知	31
1、说明	31
2、询价通知书	31
3、报价总则	31
4、质疑	34
5、合同的订立和履行	34
6、代理服务费	35
7、保证金	35
第四部分 合同书格式	37
第五部分 响应文件格式	40
附件：询问函、质疑函格式	71
1、询问函格式	71
2、质疑函格式	72

第一部分 询价邀请函

韶关市优采招标代理有限公司受韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心的委托，对韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商报价。

一、项目编号：SGYC2017025XJ

二、项目名称：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目

三、项目预算金额（元）：386,400.00

四、采购数量：1项

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

（一）采购项目内容及需求

1. 采购项目内容及需求详见该采购项目询价通知书；

2. 项目编号：SGYC2017025XJ（采购编号为采购代理机构存档识别号）

3. 供应商认为其为小型或微型企业的应当提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

4 供应商认为其为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

5 供应商认为其为残疾人福利性单位的应当提交《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

6. 本项目不接受进口产品设备。

（二）采购项目注意事项

1. 采购代理机构只接受报名购买本询价通知书供应商的报价。

2. 报名事宜：供应商须凭以下材料并加盖单位公章购买询价通知书：

（1）、提交法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证或五证合一证明等证明文件（复印件加盖公章）；

（2）、提交法定代表人/负责人资格证明书原件及法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章（若法定代表人/负责人委托报名的，应同时出具法定代表人/负责人授权委托书原件及被委托人身份证正反面复印件）。【资格证明书、授权委托书格式可参照第五部分 响应文件格式：二、资格性文件】

（三）供应商应当在参与采购活动前详细研究了询价通知书的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，且不存在任何含糊不清和误解之处，否则，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

（四）本项目监管部门：韶关市武江区财政局

六、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

注：供应商必须按询价通知书第五部分响应文件格式“2.5 关于《政府采购法》第二十二条的资格承诺函”提供《关于〈政府采购法〉第二十二条的资格承诺函》，否则，其响应文件作无效投标处理。

2、供应商必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于询价截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

4、本项目不接受联合体参加询价。

七、符合资格的供应商应当在 2017 年 11 月 01 日至 2017 年 11 月 03 日期间（办公时间内，法定节假日除外）到韶关市优采招标代理有限公司（地址：韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺 22 栋 316 号）购买询价通知书，询价通知书每套售价 200.00 元（人民币），售后不退。

八、报价截止时间：2017 年 11 月 10 日 10 时 30 分（北京时间）。

九、提交响应文件地点：韶关市优采招标代理有限公司（地址：韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺 22 栋 316 号）。

十、询价时间：2017 年 11 月 10 日 10 时 30 分（北京时间）。

十一、询价地点：韶关市优采招标代理有限公司（地址：韶关市浈江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺 22 栋 316 号）。

十二、本公告期限（3 个工作日）自 2017 年 11 月 01 日至 2017 年 11 月 03 日止。

十三、联系事项

- (一) 采购人：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心
地 址：韶关市武江区工业中路 83 号
联系人：曹先生 联系电话：0751-8730306
传 真：0751-8637998 邮编：512026
- (二) 采购代理机构：韶关市优采招标代理有限公司
地址：韶关市浚江区金汇大道 88 号鑫金汇建材家居广场条铺 22 栋 316 号
联系人：王小姐 联系电话：0751-8881466
传真：0751-8881997 邮编：512023
- (三) 采购项目联系人：王小姐 联系电话：0751-8881466

发布人：韶关市优采招标代理有限公司

发布时间： 2017 年 11 月 01 日

第二部分 用户需求书

一、采购项目技术规格、参数及要求

(一)、采购项目需求一览表

序号	采购项目	数量	主要技术规格	预算金额
1	医疗设备	1 批	详见具体用户需求书	¥386,400.00

★注：1、报价超出预算金额的列为无效报价处理。

2、供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。

3、报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

(二) 采购项目需求汇总表及详细技术参数

1、本询价通知书中所涉及的设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。供应商在本次采购中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于询价通知书的要求。

2、本项目不接受进口产品设备。

(1)、设备清单汇总表

序号	设备名称	单位	数量	备注
1	多普勒胎心仪	台	1	
2	数字式十二道心电图机	台	1	
3	除颤仪	台	1	
4	全科诊断系统	台	1	
5	全科医生健康管理一体机	台	1	
6	心电监护仪	台	1	
7	胎儿母亲监护仪	台	2	
8	无创呼吸机	台	1	
9	电动产床	台	1	
10	输液泵	台	1	
11	注射泵	台	1	
12	自动洗胃机	台	1	
13	电动流产吸引器	台	1	

(2)、详细技术参数

一、超声多普勒胎心仪技术参数

1. 超声工作频率：2.5MHz \pm 10%
2. 输出超声功率： $<5\text{mW}/\text{cm}^2$
3. 最大综合灵敏度： $\geq 90\text{dB}$
4. 胎心率检测精度： ± 2 次/min
5. 三种胎心率显示模式可选择：A. 曲线图模式；
B. 数值模式（瞬时值和平均值同屏显示）；
C. 手动工作模式。
6. 省电功能：无信号输入自动关机功能
7. 音量大小、时间、日期、电池电量及探头频率显示功能，一目了然
8. 操作更人性化：胎心率显示范围、曲线显示范围及报警功能可调
9. 使用电源：配置充电器；内置可充电式镍氢电池组

二、数字式十二道心电图机技术参数

一、工作条件：

- 1.1 产品可在电源交流 100 伏~240 伏，50/60 赫兹，室温 5—40℃和相对湿度 25%~80%的环境下正常工作
- 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、ECG 输入

- 2.1 ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集
- 2.2 导联选择：手动/自动可选，（支持 Nehb、Cabrera 导联体系）
- 2.3 输入阻抗： $\geq 50\text{M}\Omega$ （10Hz）
- 2.4 频率响应：0.05-150Hz（-3db）
- 2.5 定标电压：1mV \pm 2%
- 2.6 耐极化电压： $\pm 600\text{mV}$
- 2.7 内部噪声： $\leq 12.5\mu\text{V}_{\text{p-p}}$
- 2.8 时间常数： ≥ 3.2 s
- 2.9 共模抑制比： $\geq 121\text{dB}$ （AC 滤波开启）； $\geq 115\text{dB}$ （AC 滤波关闭）

2.10 输入电流： $\leq 0.01 \mu A$

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言

三、波形处理：

3.1 A/D 转换：24bit

3.2 采样率：1000Hz/秒/通道

3.3 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.5 自动分析功能：具有 12 导联同步自动分析以及 RR 分析功能

3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

4.1 设备内置存储器，存储病历 800 例

4.2 数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出

4.3 支持外接 U 盘和 SD 卡可扩展存储空间

五、显示器：

5.1 7 英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格

5.2 显示信息：同屏显示 12 导同步心电波形

5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

六、记录器：

6.1 热敏式点阵打印机

6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s

6.3 记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1

6.4 记录纸规格：支持卷纸或折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 或 215mm

6.5 打印方式：实时同步或连续 12 道心电波形，分段打印

6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

6.7 可直接外接打印机，通过 A4 纸打印 12 道心电波形和报告

6.8 具备在无网格纸上打印网格功能

七、功能

7.1 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率

7.2 可准确判定接触不良的电极并予以指示

7.3 拥有自动测量功能和自动诊断功能

7.4 手动、自动、节律、R-R 四种工作模式可供选择。

7.5 自动模式下可以支持 10-60S 时间的采集，记录，存储，传输。

7.6 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告

7.7 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录

7.8 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

7.9 可以选配心电向量功能

7.10 可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

八、外部输入接口：

8.1 USB 接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD 卡接口

8.2 支持内置 WiFi（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网，

8.3 支持 DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求

8.4 支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息

九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

十、电源：交直流两用 自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz

10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间 4 小时

三、除颤仪技术参数

1. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2. 整机带电极板、电池的重量不超过 6kg。
3. 除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。除颤能量为 360J，提高除颤成功率和有效性。
4. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择。
5. 除颤充电迅速，充电至 200J<5s，360J<8s。
6. 体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。
7. 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。
8. 可升级血氧饱和度监护功能、NIBP 监护功能。
9. 可充电锂电池，支持 200 次以上 200J 除颤。
10. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。
11. 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。
12. 支持中文操作界面、AED 中文语音提示。
13. 彩色 TFT 显示屏>6” ，分辨率 640×480，最多可显示 3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
14. 50mm 记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。
15. 可存储 24 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。
16. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于 150J）、屏幕、按键检测。
17. 可在-10°C 环境正常工作，存储温度-30~70°C。
18. 符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2002。
19. 符合欧盟救护车标准 EN1789:2007。
20. 具备良好的防水性能，防水级别 IPX4。
21. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受 0.75m 跌落冲击。

四、全科诊断系统技术参数

一、技术参数

- 1、 检测项目及参数：≥6 个项目，包括血压测量、血氧饱和度测量、脉搏测量、体温测量、眼（部）底检查、耳膜及耳道检查等；
- 2、 显示屏幕： TFT 彩色液晶显示屏,能输入并显示、保存病人信息资料；

- 3、 壁挂支撑结构：金属钣金件四点固定；
- 4、 血压测量：
 - A、 振波法测量原理，环保无水银；
 - B、 具备成人、儿童两种模式，一次测量提供舒张压、收缩压，平均压 3 个参数；
 - C、 根据不同操作人员的工作习惯，具有数字和电子表盘两种显示方式供选择，并同屏显示；
 - D、 具有自动充放气和手动充放气（听诊）两种测量模式，自动模式中可按照设定的时间间隔自动启动无创血压测量，时间间隔可选择。
- 5、 血氧饱和度测量：
 - A、 光电法测量原理；
 - B、 可显示血氧容积波、血氧饱和度数值及脉搏强度；
 - C、 测量范围为 0%-100%；
 - D、 血氧饱和度在 70-100%之间时测量精度 $\leq 2\%$ 。
- 6、 脉搏测量：
 - A、 光电法测量原理；
 - B、 提供数值和波形图 2 个结果参数。
- 7、 体温测量：
 - A、 红外热辐射测量原理；
 - B、 准确度 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ；
 - C、 具备温度超限报警功能；
 - D、 配备一次性防污耳套，避免交叉污染。
- 8、 眼底检查：
 - A、 ≥ 28 个屈光分度，采用无级调节，屈光度范围： $-25\sim+40\text{D}$ ；
 - B、 6 种光阑孔径，分别为大光阑、小光阑、微小光阑、裂隙片、固视光阑、钴蓝片；
 - C、 具有偏振滤光片和无赤滤光片；
 - D、 光照度可调节；
 - E、 输出照明光显色指数 $\geq 85\%$ 。
- 9、 耳膜及耳道检查：

- A、 光导纤维照明；
 - B、 医用放大镜镜头端部的照明亮度 $\geq 500 \text{ lx}$ ；
 - C、 放大镜倍数 2X；
 - D、 显示指数 $\geq 85\%$
 - E、 带鼓气孔，可以在诊断时方便进行各类辅助操作；
 - F、 配备 2.7mm，4.2mm 两种防污耳套，有效避免交叉污染。
- 11、操作方式：支持红外遥控操作，避免致使操作人员反复起身使用造成疲劳。

五、全科医生健康管理一体机技术参数

一、参数要求

- 1、具有心电图、心率、血糖、血红蛋白、血压、血氧饱和度、尿常规、体温等 8 项检测功能，能实现检查数据自动采集、存储、处理、传输等功能，具备高集成、易操作、便携带、高稳定等特点；
- 2、主机配备的彩色液晶显示屏尺寸 ≥ 7 英寸；主机适应 WIFI、有线以太网等多种网络互联方式；外接身份证读卡器；
- 3、整体设备中所有检测设备放入箱内，可单背或拉杆拖行，携带方便，整体重量 $\leq 10\text{kg}$
- 4、无创血压测量
 - 4.1、测量范围：
 - (1) 成人：
收缩压：4.0kPa \sim 34.0kPa (30mmHg \sim 255mmHg)；
平均压：2.7kPa \sim 31.3kPa (20mmHg \sim 235mmHg)；
舒张压：1.3kPa \sim 29.3kPa (10mmHg \sim 220mmHg)；
 - (2) 儿童：
收缩压：4.0kPa \sim 31.3kPa (30mmHg \sim 235mmHg)；
平均压：2.7kPa \sim 30.0kPa (20mmHg \sim 225mmHg)；
舒张压：1.3kPa \sim 29.3kPa (10mmHg \sim 220mmHg)；
 - 4.2、测量精度：平均压测量误差 $\pm 5\text{mmHg}$ 之内、标准偏差 $\pm 8\text{mmHg}$ 之内。
 - 4.3、测量分辨率：1 mmHg。

- 4.4、测量过压保护：过压保护点为 300mmHg。
- 4.5、符合《YY0670-2008 无创自测量血压计》标准。
- 5、血氧饱和度测量
 - 5.1、测量范围：35%~100%。
 - 5.2、测量精度：在 70%~100%范围内，测量误差±3%。
 - 5.3、测量方式：指夹式。
 - 5.4、分辨率：1%。
 - 5.5、标准要求：符合《YY 0784-2010 医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》。
 - 5.6、其他要求：具有低血氧报警功能。
- 6、体温测量
 - 6.1、红外体温测量，测量范围：34~42℃
 - 6.2、分辨率：0.1℃
 - 6.3、精度：±0.3℃
 - 6.4、测试时间≤1 秒，具有发烧报警功能
- 7、血糖测量
 - 7.1、测试项目：新鲜的毛细血管全血或静脉全血的葡萄糖含量
 - 7.2、测试原理：媒介体生物电化学原理
 - 7.3、测试样本用量：≤1.0uL 末梢血/静脉血
 - 7.4、测试速度：≤5s
 - 7.5、平均值：可显示 7、14、30 天平均值
 - 7.6、自动气温监测和提示；自动电池电量监测和提示；自动判断故障
 - 7.7、代码卡设置：直接使用智能代码卡，免调码
 - 7.8、蓝牙数据输出
 - 7.9、有通过 SFDA 认证的配套质控液
- 8、血红蛋白测量
 - 8.1、测试项目：新鲜的毛细血管全血血红蛋白含量
 - 8.2、测试原理：反射光度法
 - 8.3、测试速度：15 秒内显示结果
 - 8.4、测试范围：40g/L~265g/L

- 8.5、显示：液晶显示屏，测试结果采用 SI 国际单位，可显示 HCT 值
- 8.6、存储功能：可保存试剂片代码，并可自动存储和更新 1200 个样品的测试结果
- 8.7、故障提示：自动故障判断并显示故障代码
- 8.8、电源：采用 2 枚干电池供电
- 8.9、蓝牙数据输出
- 9、十一项尿常规测量
 - 9.1、检测项目：至少包括比重、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、隐血、pH 值、维生素 C 等十一项。
 - 9.2、测试速度： ≥ 60 个标本/小时。
 - 9.3、测量稳定性：分析仪开机 8 小时内，分析仪对适配的尿试纸条重复测试结果的符合率 $\geq 90\%$ 。
 - 9.4、检测结果：检测结果为定量及半定量数据，并能出具正常参考值。
 - 9.5、蓝牙数据输出；
- 10、心电工作站
 - 10.1、导联选择：为标准十二导联，包括 I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-6，并且具有十二导联同步采集，十二导联同步记录的功能。
 - 10.2、心率测量范围：包括 30bpm~300bpm。
 - 10.3、灵敏度选择：至少包括 5 mm/ mV、10 mm/ mV 二种。
 - 10.4、记录速度：至少包括 5 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50mm/s 五种。
 - 10.5、时间常数： ≥ 3.2 秒。
 - 10.6、定标电压： $1\text{mV} \pm 5\%$ 。
 - 10.7、自动功能：记录导联及增益具有自动转换或手动转换两种方式。
 - 10.8、记录模式：具有手动方式或自动方式以及长时间节律导联记录功能。
 - 10.9、安全性：当使用原装导联线时具有 BF 级别除颤保护、抗高频干扰和起搏脉冲抑制电路。
- 11、信息管理系统
 - 11.1、符合《国家基本公共卫生服务规范 2013 版》规范要求，具备建档、

修改、删除、查询等常用功能；

11.2、通过无线蓝牙技术实时采集包括无创血压、血氧饱和度、心电监测、体温测量、十一项尿常规、血糖等检验结果与波形，并进行存储，并支持查看历史结果；

11.3、支持档案打印，打印格式符合《国家基本公共卫生服务规范 2013 版》要求；

11.4、具有室内质控管理功能，并支持远程传输至上级医院进行质控指导；

11.5、支持检验结果综合打印，并能根据检验结果进行智能诊断；

11.6、打印结果可导出 PDF/BMP/JPEG/WORD/EXCEL 等格式；

11.7、具备视力表、色盲检验功能，方便进行综合检查；

11.8、可通过无线蓝牙技术联接二代身份证阅读器读取身份信息，方便操作、提高效率；

11.9、可存储超过五十万份电子健康档案、检验结果及随访记录。

11.10、可提供接口组件给卫生信息平台调用直接联接仪器采集检验、检查数据，实现数据对接。

11.11、可支持主动向卫生信息平台发送检验、检查、公卫等数据，可根据卫生信息平台开放的接口定制开发。

11.12、配置清单：

1 多参数监护仪：1 套

2 便携式尿液分析仪：1 套

3 尿试纸条：1 盒

4 医用红外体温计：1 套

5 血糖分析仪：1 套

6 血糖试条：1 盒

7 一次性使用末梢采血针：2 盒

8 平板电脑（安卓版）+适配器+SD（16G）卡：1 套

9 信息化全科医生巡诊箱：1 套

10 血红蛋白分析仪；1 套

11 台式居民身份证阅读机具：1 套

12 数字化心电工作站：1 套

- 13 信息化全科医生巡诊箱装箱清单：1 份
- 14 信息化全科医生巡诊箱配置明细清单：1 份
- 15 信息化全科医生巡诊箱使用说明书：1 本
- 16 信息化全科医生巡诊箱临床指导：1 本
- 17 信息化全科医生巡诊箱快速操作指南：1 份
- 18 健康一体机信息管理系统（安卓版）操作手册：1 本
- 19 仪器安装及用户培训记录：1 份
- 20 健康一体机信息管理系统（安卓版）验收记录表：1 份
- 21 售后服务手册：1 本
- 22 合格证：1 份

六、心电监护仪技术参数

一、监护参数

心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、脉搏（PR）、双通道体温（TEMP）、理邦/伟康 呼气末二氧化碳（EtCO₂）（选配）、双有创血压（IBP）（选配）、Phasein 麻醉气体（AG）（选配）

二、显示

1. 12.1 寸彩色 TFT 屏，分辨率：800×600
2. 全触摸屏操作，便于医护人员操作
3. 支持同屏显示 11 道波形和全部监测数据
4. 支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联
5. 可根据医护人员临床观察需要自由组合任意 4 个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持 NIBP 多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察
6. 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断
7. 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势
8. 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

三、数据存储、回顾

1. 120 小时趋势图/表存储回顾
2. 2 小时动态趋势共存图
3. 1200 组无创血压测量回顾，120 秒全息波形冻结回顾
4. 具备 USB 数据接口、SD 卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充

四、性能特点

1. 中英文操作界面，全中文按键面板
2. 标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率
3. 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态
4. 支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联
5. 心电增益有：1.25mm/mv ($\times 0.125$)，2.5 mm/mv ($\times 0.25$)，5 mm/mv ($\times 0.5$)，10 mm/mv ($\times 1$)，20 mm/mv ($\times 2$)，40 mm/mv ($\times 4$)，自动增益，多种选择，满足临床需求
6. 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护
7. 具有药物浓度计算和滴定表计算、血液动力学计算功能
8. 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征
9. 无风扇设计，低噪音，保持临床环境安静；低功耗，延长电池的使用时长；不吸尘，保持设备内外部清洁，同时降低交叉感染的可能性
10. 易清洁硅胶按键，防水防渗，防交叉感染，便于清洁
11. 支持条形码扫描功能，方便快速录入病人信息
12. 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站
13. 声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况
14. 可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率
15. 可选配美国 RESPIRONICS 旁流/主流呼气末二氧化碳，抽气速率低至 50ml/min，不再需要传统的脱水瓶
16. 可选配 Phasein 旁流/主流麻醉气体，抽气速率低至 50ml/min

17. 可内置 WiFi 模块，支持 3G\WiFi 联网功能，实现 3G\WiFi\有线等混合方式联网
18. 可选配三通道内置热敏打印机
19. 标配可拆卸充电锂电池，续航时间 ≥ 5 小时（选配）
20. 具有 RJ-45 网络口、辅助输出接口、VGA 外接显示器接口、USB 口、SD 卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）

七、胎儿母亲监护仪技术参数

1. 整机：

- 1.1 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；
- 1.2 10.1 英寸高清晰 TFT 屏， $0-60^{\circ}$ 度内多角度翻转；
- 1.3 良好的人机对话界面，多种界面可选；
- 1.4 胎心率 110-160bpm 正常范围区域标识（可调）
- 1.5 监护曲线显示支持 30 ~ 240（美标）和 50 ~ 210（国际）两种标准；
- 1.6 三种专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲监护曲线及数字显示界面；
- 1.7 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；
- 1.8 飞梭和硅胶按键操作；
- 1.9 易装纸打印结构设计，不用喂纸；
- 1.10 隐藏式提手，方便移动；
- 1.11 内置式 152mm（或 150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；
- 1.12 打印机走纸速度 1、2、3cm/min 可调，支持最高速度 25mm/s 高速回放打印；
- 1.13 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；
- 1.14 打印结束后给与声音提示；
- 1.15 每十分钟自动打印时间、日期、母亲（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

- 1.16 支持 NIBP 省纸打印;
- 1.17 胎心率报警范围可调, 当胎心率过缓或过速时自动报警, 报警内容中文显示, 报警持续时间可调;
- 1.18 具有超声传感器信号质量指示功能, 以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线;
- 1.19 双胎心率重合报警(SOV), 母胎心率信号重合验证;
- 1.20 内置专家评分系统, 提供 KREBS、Fischer、改良 Fischer 和 NST 四种评分方式;
- 1.21 在宫缩数值大于 50 单位的情况下, 在界面上弹出禁止测量血压的提示信息;
- 1.22 回顾报警功能, 可回顾最近的 100 条报警信息;
- 1.23 60 小时 CTG 存储、回放, 打印, 掉电数据存储;
- 1.24 具有查找监护记录功能;
- 1.25 中英文操作界面;
- 1.26 可选配大容量锂电池供电;
- 1.27 可外接胎儿刺激器, 刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印;
- 1.28 内置通讯接口, 可与中央站组成网络系统;
- 1.29 通过欧盟 CE 认证;
- 1.30 通过美国 FDA 认证;
2. 胎儿监护指标:
 - 2.1 胎心: 多晶片 1MHz 宽波束脉冲多普勒防水探头, 自适应追踪, 胎心信号扑捉稳定
 超声工作频率: 1MHz 超声波束声强: $I_{ob} < 3mW/cm^2$
 胎心率范围: 30~240bpm 分辨率: 1bpm
 - 2.2 宫缩压力: 无凸点探头设计, 0-100 相对单位, 分辨率: 1%
 - 2.3 胎动: 手动/自动胎动检测, 显示并打印胎儿活动图;
 AFM 范围: 0% ~100 %
3. 母亲监护指标:
 - 3.1 心电导联选择: 三导, 心率范围: 30~240 bpm, 测量精度: $\pm 1bpm$;
 - 3.2 无创血压测量方法: 振荡法, 计量单位: mmHg/Kpa 可选, 测量方式:

手动/自动，袖带压力范围：0~300 mmHg，测量范围：收缩压 40~270mmHg
平均压 20~235mmHg 舒张压 10~215mmHg，测量误差：±8bpm 或±5%（较大者）；

3.3 血氧饱和度显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值，测量范围：
50%~100%，测量误差：±1%（70%~100%测量范围）；

3.4 呼吸阻抗法，测量范围：0~120rpm，测量精度：±1rpm；

3.5 脉率显示范围：30 bpm ~ 240 bpm，测量精度：±1bpm；

3.6 体温显示范围：0° C ~ +50° C，测量精度：±0.1° C。

八、无创呼吸机技术参数

1. 通气模式：S/T、S、T、CPAP

2. 呼吸频率；

——调节范围：3 bPM~ 40 bPM

——步进：1bPM

——允差：±15 %

3. 吸气时间；

——调节范围：0.0 s ~ 3.0 s

——步进：0.1 s

——允差：±15 %或± 0.3 S 两者取大值

4. 吸气压力（IPAP）；

——调节范围：4 cmH20 ~ 25 cmH20

——步进：0.5cmH20

——允差：±（2 %满刻度+4 %实际读数）

5. 呼气压力（EPAP）；

——调节范围：4 cmH20 ~ 20 cmH20

——步进：0.5cmH20

——允差：±（2 %满刻度+4 %实际读数）

6. 持续气道正压（CPAP）；

——调节范围：4 cmH20 ~ 20 cmH20

——步进：0.5cmH20

——允差：±（2 %满刻度+4 %实际读数）

7. 压力延时上升时间；

——调节范围：0 min ~ 60 min

——步进：1 min

——允差：± 15 %

8. 压力上升时间；

——调节范围：自动调节, 0.1 s ~ 0.6 s

——步进：0.1 s

——允差：± 30%

9. 吸气灵敏度；

——调节范围：自动调节、1~3

——步进：1

10. 呼气灵敏度；

——调节范围：自动调节、1~3

——步进：1

11. 舒适度；

——调节范围：关、1~3

——步进：1

12. 湿化器；

——调节范围：0~5

——步进：1

13. 采用飞梭一键式调节、设置，简单、易学。

14. 具有 10 次倍频功能，保证患者通气安全。

15. 机身屏幕防水设计可有效避免液体渗入屏幕，进入主机。

16. 压力释放功能使患者易于接受、更快适应，早日达到使用效果。

17. 采用黑色配色，美观耐用；时尚大方。

18. 四个减震垫即可减小噪音，又可有效防止机器磨损，影响美观。

19. 独特的水盒设计，加热更加快捷。

20. 有效地防倾倒设计，充分避免湿化器水流倒灌。

21. 具有断电、托管、窒息等全面的报警功能。

九、电动产床技术参数

一、适用范围：

本产品供产妇分娩或施行一般产科手术等用。尤其适用于医院妇产科、泌尿外科各种仪器及镜类检查、诊断。

二、主要结构：

本产品床面设计呈流线形，符合患者体位。电动调节满足整体倾斜，并通过调节整体前后倾斜来调节产床的高度。

床垫为高密度海绵外包人造革，轻松卸下清洗、消毒。

床体下面安置了隐藏式的污物盆，可方便地拉出或缩进，便于处理污水及杂物。

床两侧可按客户要求加装阴道镜。

该产品配有内置应急电源，网电源断电时，可自动跳转至工作状态。

三、主要规格：

全长 $\geq 1200\text{mm}$

宽 $\geq 550\text{mm}$

床面离地最高 $\geq 1200\text{mm}$

床面离地最低 $\geq 480\text{mm}$

四、主要技术参数：

台面前倾 $\geq 20^\circ$

台而后倾 $\geq 25^\circ$

安全工作载荷：135kg

电源：交流（AC） $220 \pm 10\%$ ， $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$

设备安全分类：I类 B型

五、基本配置

拉手 2套 托腿架（含垫） 2件 污物盆 1只 床垫 1套

十、输液泵技术参数

1. 速度设定范围：1ml/h~1200ml/h(最低每级 1ml/h)

2. 流速精度： $\leq \pm 5\%$ （优质输液器经校准标定后的精度）

3. 冲洗速率：1000 ml/h
4. 输 液 量：1ml~9999ml
5. 累 计 量：0ml~9999ml（每级 0.1ml）
6. 阻塞压力范围三挡可调：高：120±26.7kPa 中：66.7±13.3kPa
低：10±6.6kPa
7. 具有 KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h~5ml/h（可调，每级 1ml/h）
8. 气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul
9. 报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输血量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO 完毕报警。
10. 阻塞后系统压力自动释放。
11. 压力动态显示及预警系统。
12. 可编程输液。
13. 卧式设计减少空间。
14. 可拆卸式动力盒便于清洗。
15. 电 源：AC220V，50HZ；内置电池：DC12V 充电电池组；电池充电 16 小时后，可供泵以 25ml/h 速率运行时，工作时间≥5.5 小时以上。
16. 18 个月储存寿命提高了电池性能
17. 功 率：39VA
18. 操作历史纪录（黑匣子）：至少 1500 条
19. 输液历史纪录：1200 条（约 7 天纪录，可从泵上查询）
20. 双单片机互监控，提高可靠性。
21. 输液器：国内各种合格品牌输液器都可以选用，前 3 个品牌输液器出厂时已经校准，输液器 4~9 需要用户自行校准。
22. 运行环境条件：a) 温度：+10~+40℃ b) 相对湿度：20%~90%
23. 专利传动系统可降低泵运行时的噪音

十一、注射泵技术参数

1 注射器规格：10 ml 、 20ml 、 30ml 、 50ml

2 注射速率

50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml 每级 0.1ml/h，1000ml 以上每级 1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h（每级 0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级 0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级 0.1ml/h）

3 快速推注

1200ml/h（50ml 注射器）

600.0ml/h（30ml 注射器）

399.9ml/h（20ml 注射器）

300.0ml/h（10ml 注射器）

4 累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以 0.1ml/h 递增；1000ml 以上，以 1ml/h 递增）

5 限制量 0—9999ml

6 精度 $\leq \pm 2\%$ （泵本身机械精度 $\leq \pm 1\%$ ）

7 电源 AC220V $\pm 22V$ 50HZ $\pm 1HZ$

DC12V 充电 16 小时后以 5ml/h 可持续工作不低于 3 小时

8 环境条件 温度- 5—40℃ 相对湿度 20%—90%

9 报警 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

10 报警优先级

11 自动识别注射器规格

12 可使用一次性注射器（包含 13 种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌

13 阻塞后针筒内压力自动释放

14 可记录 500 条以上（含 500 条）历史纪录）

- 15 RS232 电脑接口
- 16 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警
- 17 注射过程中快速推注
- 18 三档阻塞压力等级选择
 - 低 (L) 300mmHg+/- 100mmHg
 - 中 (C) 500mmHg+/- 100mmHg
 - 高 (H) 800mmHg+/- 200mmHg
- 19 KVO 速率
- 20 类型： I 类 CF 型
- 21 IP 等级： IP×4（防溅水）
- 22 符合 YY0709 国家标准
- 23 符合 YY0505 国家标准
- 24 快速推进键保险

十二、自动洗胃机技术参数

一、产品特点

- 1、自动压力反馈控制系统。
- 2、强力换向防堵结构。
- 3、压力液量双安全保护。
- 4、进出胃液量平衡控制功能。
- 5、进出胃液路分离控制结构。
- 6、进出胃动态模拟压力显示。
- 7、无油膜式泵。
- 8、具备电磁兼容功能，有效防止电磁干扰。

二、技术参数

- 1、洗胃压力： 47kPa-55kPa
- 2、出胃液量： ≤450ml/次
- 3、进胃液量： ≤350ml/次
- 4、液量平衡： ≤250ml/次

- 5、噪声： $\leq 60\text{dB(A)}$
- 6、输入功率： $\leq 80\text{W}$
- 7、电源： $\text{AC}220\text{V} \pm 22\text{V}$ $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$

三、主机、标准附件清单

- 1、主机 1 台
- 2、一次性洗胃包 3 套
- 3、防尘堵 4 个
- 4、电源线 1 根

十三、电动流产吸引器技术参数

一、技术指标：

- 1、无油免维护活塞泵
- 2、工作稳定、寿命长、噪音低
- 3、自动防溢流装置
- 4、液晶数字显示工作负压，直观、准确
- 5、带有气控防浸脚踏开关，便于手术中操作

二、技术参数：

- 1、极限负压值： -0.09MPa
- 2、负压调节范围： $-0.01\text{MPa} \sim -0.09\text{MPa}$
- 3、抽气速率： $30\text{L}/\text{min}$
- 4、电源： $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$ $50\text{HZ} \pm 2\%$
- 5、输入功率： 150VA
- 6、噪声： $\leq 55\text{dB(A)}$

三、主机、标准附件清单

- 1、主机 1 台
- 2、PC 液瓶 $2\text{L} \times 1$; $1\text{L} \times 1$
- 3、单腔吸引管 1 个
- 4、无毒液管 2 米

二、采购项目商务要求

1、供货要求：货物为本采购前原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。所报产品应提供详细的技术资料，应有产品（材质）合格证、检测报告等、应提供相关主要材质的详细资料情况。

2、报价要求：所报产品价格应为含税全包价，包括供货方设计、制造、包装、运输、保险、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、项目施工期限及要求：签订合同后项目全部内容在 20 个工作日内完成交货、安装、测试、验收（用户方造成延误除外）。（具体按合同执行）

4、交货地点：采购人指定。

5、售后要求：

①所供设备及软件要求提供 1 年全免费保修保用服务,如原厂家有更长保修限以厂家提供的为准。

②保修期内若设备出现故障，承建商必须在收到使用单位通知后 1 小时内技术支持响应，如有需要上门服务的 4 小时内到达现场处理故障。报修 48 小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由承建商按原型号或升级型号进行更换。

③自验收合格日计算，成交供应商负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内，不再收取任何费用，并提供终身维修服务。

④所有产品保修服务方式均为成交供应商上门保修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

⑤其他服务：供应商自行制定详尽的售后服务承诺。

6、验收要求：

交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合采购文件和成交供应商投标文件的要求；

③货物来源国官方标准；

④货物运抵现场后，采购人将对产品质量、规格等进行检验。如发现产品与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或提出索赔要求。

⑤工程完工后，以实际采购和施工项目为准结算，由施工方提出验收申请，15天内由用户单位组织人员共同对工程进行验收。

7、付款方式：（以签订合同为准）

由采购人按下列程序付款：

7.1. 在项目交货，完成安装调试后，采购人组织验收，验收合格后成交供应商开具发票，采购人收到发票后 15 日内向成交供应商支付 100% 合同款。

7.2. 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- （1）合同；
- （2）成交供应商开具的正式发票；
- （3）验收报告（加盖采购人公章）；
- （4）成交通知书。

7.3. 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第三部分 报价须知

1、说明

1.1 适用范围

本询价通知书仅适用于本询价邀请中所叙述的项目采购。

1.2 定义

- (1) “采购代理机构”系指组织本次招标的韶关市优采招标代理有限公司。
- (2) “供应商”系指提交响应文件的合格响应供应商。
- (3) “货物”系指卖方按询价通知书规定，须向买方提供货物以及其它有关技术资料 and 材料。
- (4) “服务”系指询价通知书规定供应商须承担的运输、调试、人员培训、技术服务、售后服务和其它类似的义务。

1.3 无论采购过程和结果如何，响应供应商承担所有与其参加采购有关的全部费用。

2、询价通知书

2.1 询价通知书的组成

- (1) 询价邀请函
- (2) 用户需求书
- (3) 报价须知
- (4) 合同
- (5) 响应文件格式
- (6) 在采购过程中由采购代理机构或采购人发出的修正和补充文件等

2.2 询价通知书的补充和修改

2.2.1 采购代理机构或者采购人可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构或者采购人应当以书面形式或在指定媒体上公布通知所有获取询价通知书的潜在响应供应商；采购代理机构或者采购人可适当顺延提交响应文件的截止时间。修改后的内容是询价通知书的组成部分，潜在响应供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认，如没有以书面形式向采购代理机构确认的，视作同意修改内容。

2.2.2 响应供应商在规定的时间内未对询价通知书澄清或提出询问的，采购代理机构或者采购人将视其为无异议。对询价通知书中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3、报价总则

3.1 响应文件的编写

3.1.1 响应供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，并按询价通知书要求提交完整的响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“询价通知书”做出实质性响应，否则，其报价将被拒绝。

3.1.2 报价语言和计量单位

响应文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 响应文件的组成

3.2.1 响应供应商准备的响应文件应包括以下部分：

响应文件

报价价格表

设备清单、型号规格、技术参数

项目工期及施工方案

售后服务方案

其它相关文件

3.2.2 响应供应商资格证明文件

3.2.2.1 响应供应商应按询价通知书的要求，提交证明其有资格参加报价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 财务状况报告（1、资产负债表 2、损益表）（复印件加盖公章）。

3.2.2.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

3.2.2.3 证明报价标的的合格性和符合询价通知书规定的文件。

3.3 报价

3.3.1 全部响应文件应一式三份，正本一份，副本两份，并且注明“正本”和“副本”。如果正本与副本有不符，应以正本为准。响应文件应由响应供应商的合法授权代表正式签署，任何更改(如果有的话)应由原签署人签字。

3.3.2 响应供应商应对本次询价的全部项目进行报价。

3.3.3 供应商应按要求填写报价，并写明报价的单价和报价总价，如果单价和总价有出入，以总价为准。

3.3.4 报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

3.3.5 如响应供应商对指定的采购要求建议做任何改动，应在报价中清楚注明。

3.3.6 资格文件视为响应文件不可分割的一部分。

3.3.7 所有响应文件应在投标截止日前送达采购代理机构，任何迟于这个时间的报价将被拒绝。

3.3.8 所有响应文件必须封入密封的信封或包装内，在信封或包装的封口处加盖公章。响应文件的正本和副本应分别封装，并在每信封的封面上写明：

收件人名称及地址

项目编号

项目名称

响应供应商名称、地址

3.3.9 采购代理机构对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.10 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真报价。

3.4 报价有效期

响应文件从开标之日起，有效期至确定成交单位并签订合同之日止。

3.5 报价的修改：在报价截止日前响应供应商可以修改其报价，但必须以书面形式通知采购代理机构，报价截止后不得修改其报价。

3.6 报价的撤回：在报价截止日前响应供应商可以撤标、但在报价截止后不允许撤标。

3.7 开标、评审和授标

3.7.1 采购代理机构在报价邀请中规定的时间和地点内开标。

3.7.2 采购代理机构将只对确定为实质上响应询价通知书要求的报价进行评价和比较且合理低价中标。

3.7.3 对响应文件中的任何疑义或表达不清的内容，采购代理机构有权要求响应供应商予以澄清。

3.7.4 合同将授予符合询价通知书要求及对用户最为有利的响应供应商。但采购代理机构没有义务必须接受最低报价的投标。

3.7.5 采购代理机构有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对响应供应商的影响不负任何责任，同时对此不作任何解释。

3.8 评审过程的保密性

3.8.1 开标后，直至成交供应商与用户签订协议时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向响应供应商及与评审无关的其他人透露。

3.9 无效报价行为的认定

- 1) 响应供应商未提交保证金或金额不足、保证金提交形式不符合询价通知书要求的；
- 2) 报价总金额超过本项目采购预算；
- 3) 响应供应商的响应文件或资格证明文件未提供或不符合询价通知书要求的；
- 4) 不具备询价通知书中规定“响应供应商资格”的；
- 5) 未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；
- 6) 响应文件无法定代表人/负责人签字或签字人无法定代表人/负责人有效授权的；
- 7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- 8) 响应文件对询价通知书中实质性的（即标注★号条款）技术与商务条款产生偏离的。
- 9) 符合询价通知书中规定的被视为无效报价的其它条款的。
- 10) 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

3.10 评审

3.10.1 询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价通知书规定最低要求的供应商列为推荐成交的候选对象，采购人依照推荐候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商，次低价者可预设为替补候选人。

3.10.2 响应供应商所投项目内含节能、环保产品的投标报价占投标总价 60%或以上的，按以下原则处理：

对设备采购具有节能、环保标志的产品价格高于其同类的其它产品 10%以内的，确定为成交产品。

3.10.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的有关规定，按以下原则处理：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。

3.10.4 残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业：

3.10.4.1 供应商认为其为小型或微型企业的应当提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.10.4.2 供应商认为其为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.10.4.3 供应商认为其为残疾人福利性单位的应当提交《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.11 授标

3.11.1 询价小组应对为确定为符合要求的响应文件进行校核，并根据技术、财务状况、业绩、综合报价、产品性能、信誉及服务承诺、对询价通知书的响应程度等指标分别对响应文件进行综合评价。

3.11.2 被确定为成交人将在指定媒体公告，公告后即向其发出《成交通知书》，不在成交名单之列者即默认为落标，采购代理机构不再以其它方式另行通知，对中标与落标原因不作任何解释。

4、质疑

4.1 响应供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以实名书面形式（原件）向采购代理机构或采购人提出询问或质疑。

4.2 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4.3 供应商提出质疑的必须满足以下条件：

4.3.1 有明确的质疑对象；

4.3.2 有基本事实及证据；

4.3.3 符合法定的时效要求；

4.3.4 履行必要的工作程序。

4.4 供应商提出质疑书中应包括以下内容：

4.4.1 质疑供应商的名称、地址、邮政编码、联系电话及联系人；

4.4.2 质疑的具体内容及相关事实证据；

4.4.3 法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

4.4.4 其他需要提供的内容等。

4.5 质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

注：供应商必须向采购代理机构支付询价通知书工本费后才能作为响应供应商，对询价通知书提出质疑。供应商提起质疑时需向采购代理机构或采购人索取质疑受理回执书，受理日期以质疑受理回执日期为准。

5、合同的订立和履行

5.1 合同的订立

5.1.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按询价通知书要求和成交供应商响应文件的承诺签订政府采购合同，但不得超出询价通知书和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

5.1.2 签订政府采购合同后 7 个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

5.2 合同的履行

5.2.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

5.2.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照额有关规定备案。

6、代理服务费

代理服务费是采购代理机构根据政府许可收取的代理服务费。成交供应商在领取《成交通知书》前应向采购代理机构交纳代理服务费，该收费根据广东省物价局（粤费SFF15005 号）规定的收费标准，按照成交总金额以差额定率累进法（如下表）计算（代理服务费不足 5,000.00 元按 5,000.00 元收取）：

货物类 收费 标准	中标金额 (万元)	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-1 亿	1 亿-5 亿
	费率	1.5%	1.1%	0.8%	0.5%	0.25%	0.05%
服务类 收费 标准	中标金额 (万元)	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-1 亿	1 亿-5 亿
	费率	1.5%	0.8%	0.45%	0.25%	0.1%	0.05%
工程类 收费 标准	中标金额 (万元)	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-1 亿	1 亿-5 亿
	费率	1%	0.7%	0.55%	0.35%	0.2%	0.05%

例如：某服务招标中标金额为 850 万元，计算代理服务收费额如下：

100 万元×1.5%=1.5 万元

(500-100) 万元×0.8%=3.2 万元

(850-500) 万元×0.45%=1.575 万元

合计收费=1.5+3.2+1.575=6.275 (万元)

代理服务费账户：

户名：韶关市优采招标代理有限公司

账号：4471 1801 0400 04658

开户行：中国农业银行股份有限公司韶关碧桂园支行

7、保证金

7.1 响应供应商应按询价通知书规定的金额和期限交纳保证金，保证金作为询价通知书

的组成部分。

7.2 响应供应商应在递交响应文件前（2017 年 11 月 08 日 17 时 00 分前）提交人民币柒仟元（¥7,000.00 元）的保证金，通过银行转账或电汇的方式提交。

保证金账户：

户名：韶关市优采招标代理有限公司

账号：4405 0162 0043 0000 0117

开户行：中国建设银行股份有限公司韶关凤凰城支行

7.3 提交保证金的供应商须已报名本项目。响应供应商与交款人名称必须一致，不接受现金或分批次缴款，非响应供应商缴纳的保证金无效。凡未按规定交纳保证金的，其响应文件为无效报价。

7.4 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

7.5 成交供应商的保证金,在与采购人签订采购合同后 5 个工作日内不计利息原额退还（成交供应商凭采购合同办理保证金退还手续）。

第四部分 合同书格式

韶关市政府采购
合 同 书
(货物类)

采购编号：_____

项目名称：_____

备注：本合同格式书仅供参考，采购人与成交供应商须根据本项目要求和自身情况协商填写

甲 方：_____ 传 真：_____ 地 址：_____
 电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____
 乙 方：_____ 传 真：_____ 地 址：_____
 电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____
 项目名称：_____ 采购编号：_____

根据_____项目名称（项目采购编号）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
合计总额：¥ _____ 元； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求：详见《用户需求书》

四、交货期、交货方式及交货地点：：详见《用户需求书》

五、付款方式：详见《用户需求书》

六、质保期及售后服务要求：详见《用户需求书》

七、安装与调试：详见《用户需求书》

八、验收：详见《用户需求书》

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本

合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、响应文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式____份。

甲方（盖章）：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

乙方（盖章）：

代表：

签定日期： 年 月 日

第五部分 响应文件格式

温馨提示:

1. 本部分仅供参考。
2. 供应商应当编制响应文件一式三份以及唱标信封一份，其中正本一份和副本二份（响应文件的副本可采用正本的复印件）。
3. 供应商应当将响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号、采购编号和“在（询价通知书中规定的询价日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应当加盖供应商公章。
4. 供应商应当将《报价一览表》（从响应文件正本中复印并盖章）、《明细报价表》（从响应文件正本中复印并盖章，并以光盘形式提交电子版）、优惠或折扣说明（如有）单独密封提交，信封上应当注明采购项目名称、采购项目编号、采购编号和“在（询价通知书中规定的询价日期和时间）之前不得启封”以及“唱标信封”的字样，封口处应当加盖供应商公章。

响应文件 (正本/副本)

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

供应商名称：

日期： 年 月 日

一、 自查表

1.1、 资格性/符合性自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资格性 检查	报价函	按对应格式文件填写、签署、盖章 (原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第()页
	法定代表人/负责人 资格证明书及 授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第()页
	保证金(保证金 交纳凭证)	人民币元整(¥元)(转帐、汇款 的提供复印件加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第()页
	准入条件 (关于资格的 声明函)	见响应供应商资格	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第()页
	其他要求	按投标资料清单中规定提供“必须 提交”的文件资料	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第()页
符合性 审查	报价人的合格性	在参与政府采购活动中未有违法违 纪行为并受过处罚	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第()页
		在经营范围内报价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第()页
	技术要求	实质性响应标书中“★”号参数的 技术要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第()页
	商务要求	实质性响应标书中“★”号参数的 商务要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第()页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第()页
	其它	实质性响应询价通知书中规定的其 它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第()页

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，在对应的打“√”。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

二、资格性文件

2.1 报价函

韶关市优采招标代理有限公司：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号）项目采购货物及服务的询价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件**正本份，副本份**。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受询价通知书的各项要求，遵守询价通知书中的各项规定，按询价通知书的要求提供报价。
2. 报价有效期为递交响应文件之日起 60 天，中标/成交供应商投标有效期延至合同验收之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部询价通知书及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价通知书的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5. 我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重询价小姐所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
7. 我方同意按询价通知书规定向采购代理机构交纳代理服务费。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商代表签字：

响应供应商名称(公章)：

日期：

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：韶关市优采招标代理有限公司：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：单位：（盖章）

附：代表人性别：年龄：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：韶关市优采招标代理有限公司：

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与本采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

。

授权单位：_____（盖章）

法定代表人：_____（签名或盖私章）

有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

签发日期：

附：代理人性别：年龄：职务：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

授权代表身份证复印件正面

授权代表身份证复印件反面

2.3 保证金交纳凭证

韶关市优采招标代理有限公司：

(响应供应商全称)参加贵方组织的项目（采购项目编号为的采购活动。按询价通知书的规定，已通过（转帐、银行汇款等）形式交纳人民币(大写)元的保证金。

响应供应商名称：

响应供应商开户银行：

响应供应商银行帐号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，(采购代理机构)依据此凭证信息退还保证金。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1、响应供应商投标响应时，应当按询价通知书要求交纳保证金。保证金可以采用转帐、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2、成交供应商的保证金,在与采购人签订采购合同后 5 个工作日内不计利息原额退还（成交供应商凭采购合同办理保证金退还手续）。

2.5 关于《政府采购法》第二十二条的资格承诺函

关于《政府采购法》第二十二条的资格承诺函

韶关市优采招标代理有限公司：

我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

- (1) 我方具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方响应文件作无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

响应供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

三、商务部分

3.1 响应供应商概况

一、响应供应商情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	2		
	职工总数	人	建筑面积	2		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值万元		
		负债	万元	固定资产净值万元		
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率

注：

- 1) 文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。
- 2) 图片描述：经营场所、主要经营项目等。
- 3) 响应供应商必须提供近年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。
- 4) 如响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/ 传真
响应供应商情况	单位名称： 注册资本： 法定代表人： 代理产品： 网址：	Name： Tel： Fax：
设在广东省内的 售后服务机构情 况	机构名称： 地址： 负责人： 服务机构性质：企业自有/委托代理	Name： Tel： Fax：

三、同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额 (万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。响应供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

涉及的另一方或另几方	争端的原因	涉及的金额

五、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

3.2 规章管理制度一览表（可选）

（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等，提供附复印件并加盖公章）

序号	相关规章管理制度名称	开始执行时间	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
.....			

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

3.3 商务条款响应表

(1) 实质性响应商务条款（“★”项）响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

注：

1、对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、当询价通知书中未设置“★”项商务条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

(2) 一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格响应供应商、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	报价有效期：90 天投标有效期为自递交响应文件起至确定正式中标供应商止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
6	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价		
7	主要关键设备均为近 一个月 内原厂生产的非淘汰类全新产品		
8	交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收		
9	质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。		
10	同意接受合同范本所列述的各项条款		
11	同意按本项目要求缴付相关款项		
12	同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
13	其它商务条款偏离说明：		

注：对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

(3) 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

四、技术部分

4.1 货物说明一览表

货物名称	规格及型号	数量	交货期	备注

注：附以下材料：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。
2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。
3. 如本表格式内容不能满足需要，响应供应商/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

4.2 技术条款响应表

(1) 实质性响应技术条款（“★”项）响应表

序号	询价规格/要求	响应实际参数 (响应供应商应按响应货物/ 服务实际数据填写, 不能照 抄询价要求)	是否偏离(无偏 离/正偏离/负偏 离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 响应供应商必须对应询价通知书“采购项目技术规格、参数及要求”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合询价要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、当询价通知书中未设置“★”项技术条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项技术条款。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

(2) 一般技术条款响应表

序号	询价规格/要求	响应实际参数 (响应供应商应按响应货物/ 服务实际数据填写, 不能照 抄询价要求)	是否偏离 (无偏 离/正偏离/负偏 离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 响应供应商必须对应询价通知书“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标/询价要求。

2. 响应供应商响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。

供应商 (盖章):

授权代表 (签字):

职务:

日期: 年月日

(3) 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 设备配置简介
2. 设备技术特点说明及详细方案

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

4.3 拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

4.4 主要设备一览表

设备名称	规格型号	数量	出厂日期	设备原值
1				
2				
3				
...				

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

4.5 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定年月日	签定合同并生效	
2	月日一月日		
3	月日一月日		
4	月日一月日	质保期	

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

4.6 组织实施方案

响应供应商应按询价通知书要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，询价小组可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

- 1) 对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）
- 2) 针对本项目的组织实施方案
- 3) 进度计划和保证项目完成的具体措施
- 4) 项目整体验收计划
- 5) 培训计划
- 6) 报价人认为必要的其它内容。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

五、价格部分

5.1 报价一览表

采购项目名称：_____

项目编号：_____

报价项目	金额（元）	备注
项目费用		
各种税费		
其他费用		
总报价	（大写）人民币元 整（¥ 元）	
备注：详细内容见《报价明细报价表》。		

注：1. 响应供应商须按要求填写所有信息。

2. 所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

5.2 报价明细报价表

- 注：1. 报价明细报价表必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。
2. 报价明细报价表可根据项目实际情况做适当调整。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

5.3 节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称：_____

项目编号：_____

序号	节能、环保产品名称	品牌型号	数量	单价	总价
1					
2					
3					
4					
合计					
所投项目内节能、环保产品占投标总报价%					

注：1、各响应供应商所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的最新一期《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2、上表内行数不够的自行添加。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：年月日

5.4 中小企业声明函（小型、微型企业须提供此函方可享受相应优惠政策；非小型、微型企业可不提供。）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

5.5 残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位须提供此函方可享受相应优惠政策；非残疾人福利性单位可不提供。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

六、唱标信封（独立封装，此本部分必须与正本保持一致，但非正本组成部分）

信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号、采购编号和“在（询价通知书中规定的询价日期和时间）之前不得启封”和“唱标信封”的字样，封口处应当加盖供应商公章，并将下列内容单独密封装入“唱标信封”：

1. 《报价一览表》（从投标文件正本中复印并盖章）。
2. 《明细报价表》扫描件（从投标文件正本中扫描，以光盘形式提交）。
3. 优惠或折扣说明（如有）。

附件：询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1、询问函格式

询问函

采购代理机构或采购人：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号： ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、 _____（事项一）
 - （1） _____（问题或条款内容）
 - （2） _____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3） _____（建议）
- 二、 _____（事项二）
-

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人/负责人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

注：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- 2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- 3) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑函格式

质疑函

采购代理机构名称：

我公司依法参与了（采购代理机构名称或采购人）于____年_月_日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我认为（采购项目名称）（采购项目编号：_____）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（ ）质疑采购文件

1. 质疑内容采购文件____页，内容“_____”
损害了我公司权益

事实依据：_____（证据见附件第页）

法律依据：_____

我方请求采购文件做如下修改：_____

我方对采购文件其他内容无质疑。

（ ）质疑采购过程

1. 于_年_月_日，在_____进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：_____（证据见附件第页）

法律依据：_____

我方请求：_____

我方对其他采购过程无质疑。

（ ）质疑采购结果

1. 于_年_月_日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：_____（证据见附件第页）

法律依据：_____

我方请求：_____

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商：_____（签章） 法定代表人：_____（签名或盖章）

主要负责人：_____（签名或盖章），职位：_____

项目联系人：_____ 电话（手机/座机）：_____

地址：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

_____年__月__日

注：

1. 每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2. 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3. 质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，采购代理机构名称将有可能不予受理。